

使用说明书

HDSP-500 SF6 气体纯度分析仪

武汉恒电高测电气有限公司

WuHan HengDian GaoCe Electric Co., Ltd



目录

一、技术特点及参数	3
1、技术特点.....	3
2、技术参数.....	3
二、仪器面板说明	4
1、前面板.....	4
2、后面板.....	4
3、液晶屏.....	5
三、测量方法.....	5
四、菜单操作.....	6
1、开始测量.....	6
2、历史数据.....	7
3、设置时间.....	7
4、删除记录.....	7
五、注意事项.....	8



一、技术特点及参数

1、技术特点

- 便携式设计：仪器更轻，携带、使用方便。
- 测量快速：仪器开机后无需等待，即刻测量，快速得到纯度值。
- 快速省气：测定时耗气仅 0.5L（101.2kPa）左右。
- 自锁接头：采用德国原装进口自锁接头，安全可靠，无漏气。
- 数据存储：采用大容量设计，最多可存储 100 组测试数据。
- 显示清晰：液晶屏直接显示纯度值、时间及日期、电池电量等内容。
- RS232 接口：可与串口打印机相连，进行数据打印。
- 内置电源：内置 4Ah 可充锂电池，一次充足可连续工作 10 小时。

2、技术参数

纯度	测量范围	0%~100%
	测量精度	±0.5%
	测量时间	<2 分钟。
环境温度	-40℃~+60℃	
环境湿度	0~100% RH	
电源	AC 220V	
	内置充电电池	
电池性能	充电时间 20 个小时以上，可使用 10 小时	



重量	3 公斤
尺寸	250×100×300mm ³
工作温度	－30℃～＋50℃

二、仪器面板说明

1、前面板



注：同时按下两侧的支架调解按钮，可以调节支架的角度。

2、后面板





3、液晶屏



三、测量方法

1、连接 H2 设备

将测量管道上螺纹端与开关接头连接好，用扳手拧紧，关闭测量管道上另一端的针型阀；

再把测试管道上的快速接头一端插入纯度仪上的采样口；

将排气管道连接到出气口。

最后将开关接头与 H2 电气设备测量接口连接好，用扳手拧紧；

2、检查电量

本仪器推荐优先使用交流电。

使用直流电时，请查看右上角显示的电池电量，如果电量低于约 20%，请关机充电后继续使用。

3、开始测量

首先全部打开仪测量管道上的针型阀，然后用面板上的流量阀调节流量，把流量调节到 0.5L/M 左右，开始测量 H2 纯度。

测量 1~2 分钟，待数据稳定后即可读取或保存



4、存储数据

设备测量完成后，可以将数据保存在仪器中，按“确定”键调出操作菜单，具体操作方式见下节内容。

5、测量其他设备


一台设备测量后，关闭测量管道上的针型阀和纯度仪上的调节阀。将转接头从 H2 电气设备上取下。如果需要继续测量其他设备，按照上面步骤继续测量下一台设备。

6、测量结束

所有设备测量结束后，关闭纯度仪电源。

四、菜单操作

开机后自动进入主菜单页面(如图)，通过上下键及确定键可以进入各功能菜单。

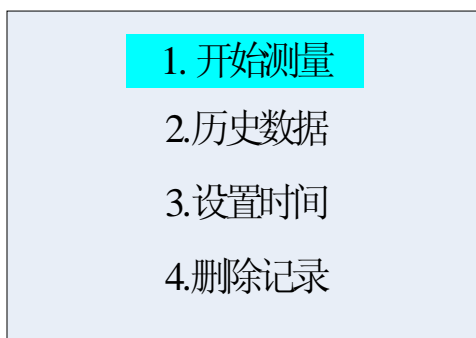

1、开始测量

在主菜单状态，按“上”、“下”键选择“开始测量”，按“确认键”可以进入测量数据页面，仪器即开始实时测量 H2 纯度并显示。



在此页面用户可按“确认键”进入“保存页面”。用户可输入设备编号(为五位):通过“上”、“下”键增加数值大小,“左”、“右”键调整数据位数。

输入编号后,按“确认”键,完成保存数据。按“返回”键可以返回上一页,此时不保存数据。

2、历史数据

在主菜单状态,按“上”、“下”键选择“历史数据”,按“确认键”可以进入历史数据页面,按“上”、“下”键可分别选择查看第一记录和最后一条记录,按“上”、“下”键翻看数据。

3、设置时间

在主菜单状态,按“上”、“下”键选择“设置时间”,按“确认键”可以进入设置时间页面。

通过“上”、“下”键可以减小或增加时间数值,“左”、“右”键可以转到下一个或上一个修改域内,按“确定”键完成设置,按“取消”键则本次设置无效。

4、删除记录

在主菜单状态,按“上”、“下”键选择“删除记录”,按“确认键”可以进入删除记录页面。

在此页面用户可按“确定键”,可删除所有数据,按“取消键”则返回。



五、注意事项

仪器应放置在安全位置，防止摔坏，避免剧烈震动；

勿测有腐蚀性的气体；

调节气体流量时，流量阀应缓慢打开，使流量指示在 0.5 升/分钟左右；

仪器使用前，应及时充电。充电时只需将电源线接入 220V 插座，无需打开电源开关，仪器将自动充电，充电时间一般需要 20 个小时以上。